


Anleitung zur Ausführung der Geräteinventur



Schritt 1: Klicken Sie im Kundenportal bitte auf Reiter „Support“



Stöbern Sie in unserem Katalog

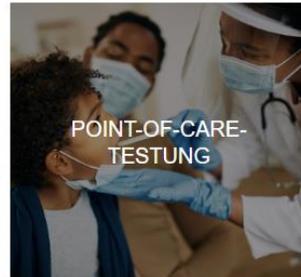

Ankündigungen


Template

2023-08-14
Produktdokumentation im Resource Center

2023-08-13
Verlinkung von QC-Zertifikaten für Ihre Reagenzien

[Mehr dazu](#)

Schritt 2: Bitte klicken Sie im Dropdown auf „Systems Overview“

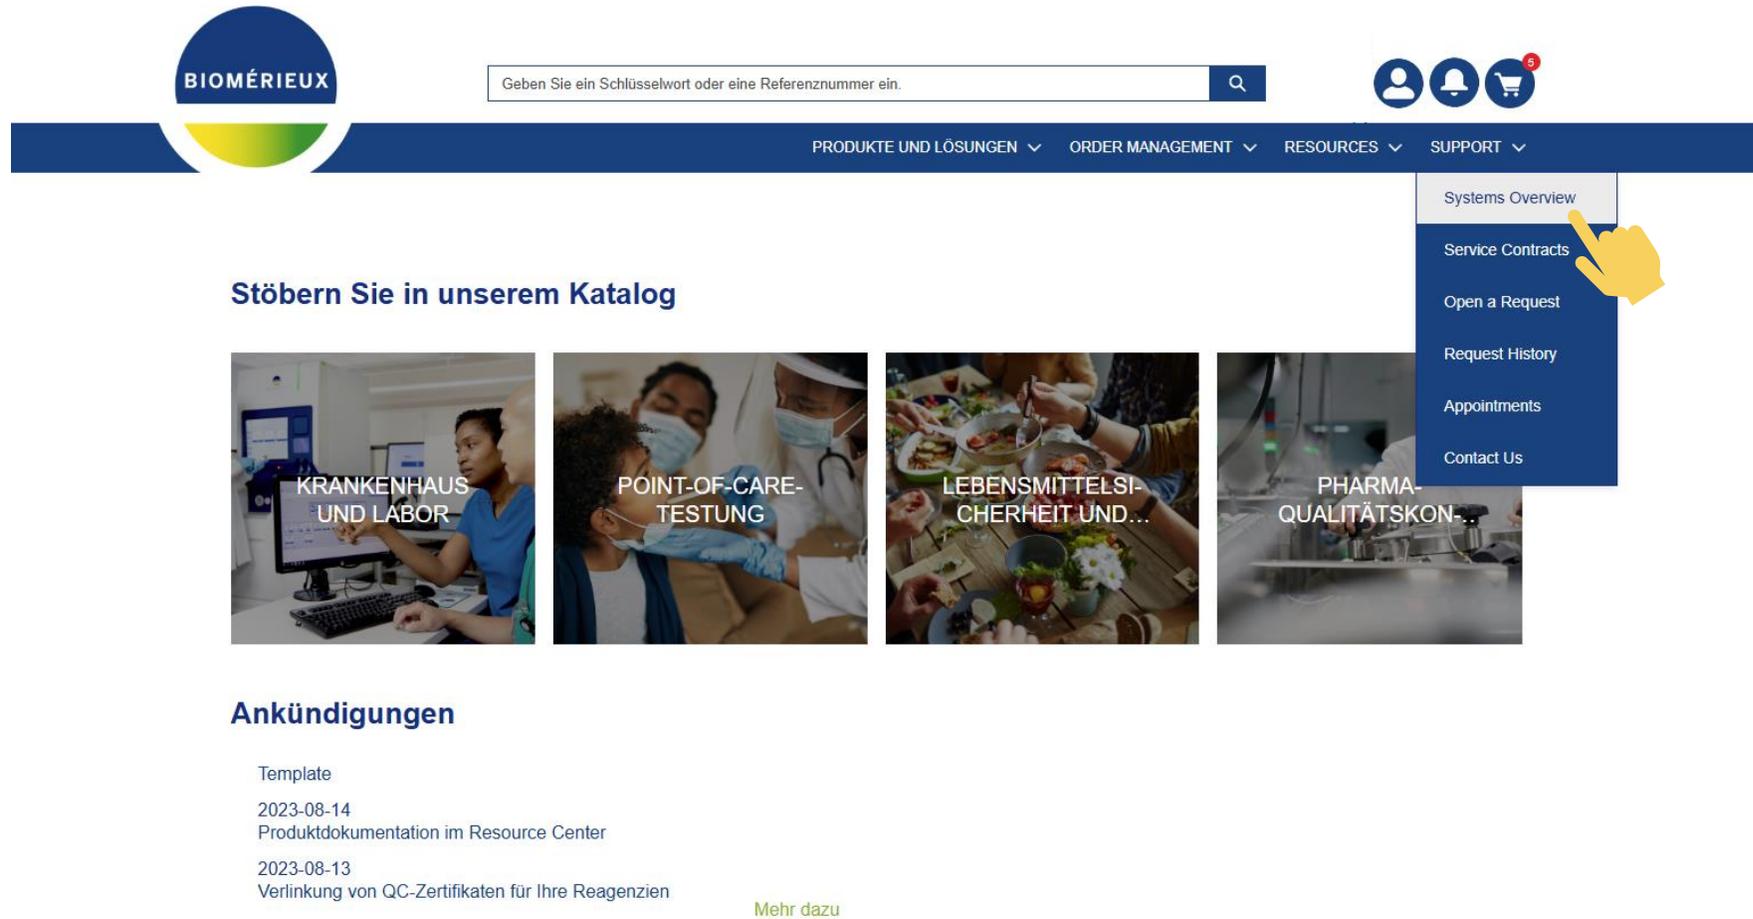

The screenshot shows the Biomérieux website interface. At the top left is the Biomérieux logo. A search bar contains the text "Geben Sie ein Schlüsselwort oder eine Referenznummer ein." with a magnifying glass icon. To the right are icons for user profile, notifications, and a shopping cart with a red '5' badge. A dark blue navigation bar contains the following menu items: "PRODUKTE UND LÖSUNGEN", "ORDER MANAGEMENT", "RESOURCES", and "SUPPORT". The "SUPPORT" menu is open, showing a dropdown list with the following options: "Systems Overview", "Service Contracts", "Open a Request", "Request History", "Appointments", and "Contact Us". A yellow hand icon is pointing to the "Systems Overview" option. Below the navigation bar, there is a section titled "Stöbern Sie in unserem Katalog" with four image-based categories: "KRANKENHAUS UND LABOR", "POINT-OF-CARE-TESTUNG", "LEBENSMITTELSICHERHEIT UND...", and "PHARMA-QUALITÄTSKON...". Below this is a section titled "Ankündigungen" with two announcements: "2023-08-14 Produktdokumentation im Resource Center" and "2023-08-13 Verlinkung von QC-Zertifikaten für Ihre Reagenzien". A green link "Mehr dazu" is positioned to the right of the second announcement.

BIOMÉRIEUX

Geben Sie ein Schlüsselwort oder eine Referenznummer ein.

PRODUKTE UND LÖSUNGEN ▾ ORDER MANAGEMENT ▾ RESOURCES ▾ SUPPORT ▾

Systems Overview
Service Contracts
Open a Request
Request History
Appointments
Contact Us

Stöbern Sie in unserem Katalog

KRANKENHAUS UND LABOR
POINT-OF-CARE-TESTUNG
LEBENSMITTELSICHERHEIT UND...
PHARMA-QUALITÄTSKON...

Ankündigungen

Template
2023-08-14
Produktdokumentation im Resource Center
2023-08-13
Verlinkung von QC-Zertifikaten für Ihre Reagenzien

Mehr dazu

Schritt 3: Bitte klicken Sie nun in der nächsten Ansicht auf den Reiter „Ausstehende Aktion“



SYSTEMÜBERSICHT **AUSSTEHENDE AKTION**

System-Namen suchen Standort **alle Standorte**

Standortadresse	System-Name	System-Nummer	Anzahl der offenen Anfr...	System-Status	VILINK	Einzelheiten zum System
Ihre Adressdaten	SYS-APIWEB	Systemnummer	0	Aktiv	✕	🔍
Ihre Adressdaten	SYS-BacT/ALERT 3D 0480	Systemnummer	0	Aktiv	✕	🔍
Ihre Adressdaten	SYS-BacT/ALERT 3D 0960	Systemnummer	0	Aktiv	✕	🔍
Ihre Adressdaten	SYS-MiniVIDAS	Systemnummer	0	Aktiv	✕	🔍
Ihre Adressdaten	SYS-MYLA-MAESTRIA	Systemnummer	0	Aktiv	✕	🔍
Ihre Adressdaten	SYS-OBSERVA	Systemnummer	0	Inaktiv	✕	🔍

Schritt 4:

Option A → Sofern keine Änderung erwünscht ist, können Sie das jeweilige Gerät anklicken und bestätigen.

The screenshot shows the BIOMÉRIEUX web application interface. At the top, there is a search bar with the text "Geben Sie ein Schlüsselwort oder eine Referenznummer ein." and a magnifying glass icon. To the right of the search bar are icons for user profile, notifications, and a shopping cart with a red notification badge. Below the search bar is a navigation menu with the following items: "PRODUKTE UND LÖSUNGEN", "ORDER MANAGEMENT", "RESOURCES", and "SUPPORT".

The main content area is titled "SYSTEMÜBERSICHT" and "AUSSTEHENDE AKTIONEN". Below this, there is a search input field for "Search equipment name" and a dropdown menu for "Standort wählen" currently set to "alle Standorte".

The central part of the interface is a table with the following columns: "Gerätename", "Standortadresse", "Verbunden mit", "Seriennummer", "Seriennummer, Datum der letzte", and "Update anfordern". The first row is highlighted in blue and has a yellow hand icon pointing to its checkbox. The other rows have unselected checkboxes. Each row has a blue circular icon with a white arrow pointing outwards in the "Update anfordern" column.

Gerätename	Standortadresse	Verbunden mit	Seriennummer	Seriennummer, Datum der letzte	Update anfordern
<input checked="" type="checkbox"/> ARROW - EASYMAG W7 COMPUTER HP RP5800 - 419721	Ihre Adressdaten	SYS-easyMAG	Seriennummer	2023-12-04	
<input type="checkbox"/> BTA3D COMBO MOD RIGHT [U] - 200290U	Ihre Adressdaten	SYS-BacT/ALERT 3D 0120	Seriennummer	2023-07-18	
<input type="checkbox"/> KIT DENSICHEK PLUS INSTRUMENT - 21250	Ihre Adressdaten	SYS-VITEK 2 0120	Seriennummer	2017-09-14	
<input type="checkbox"/> KIT DENSICHEK PLUS INSTRUMENT - 21250	Ihre Adressdaten	SYS-VITEK 2 0120	Seriennummer	2014-09-22	

At the bottom right of the page, there is a blue button labeled "SERIENNUMMER BESTÄTIGEN" with a yellow hand icon pointing to it.

Schritt 4:

Option B → Bitte klicken Sie nun das gewünschte System an und fordern Sie ein Update an, sofern eins erforderlich ist.

The screenshot shows the BIOMÉRIEUX web application interface. At the top, there is a search bar with the text "Geben Sie ein Schlüsselwort oder eine Referenznummer ein." and a magnifying glass icon. To the right of the search bar are icons for user profile, notifications, and a shopping cart with a red notification badge. Below the search bar is a navigation menu with the following items: "PRODUKTE UND LÖSUNGEN", "ORDER MANAGEMENT", "RESOURCES", and "SUPPORT".

The main content area is titled "SYSTEMÜBERSICHT" and "AUSSTEHENDE AKTION". Below this, there is a search bar for "Search equipment name" and a dropdown menu for "Standort wählen" set to "alle Standorte".

The main table displays a list of equipment with the following columns: "Gerätename", "Standortadresse", "Verbunden mit", "Seriennummer", "Seriennummer, Datum der letzte", and "Update anfordern". A yellow hand cursor is pointing to the "Update anfordern" button for the first row.

<input type="checkbox"/>	Gerätename	Standortadresse	Verbunden mit	Seriennummer	Seriennummer, Datum der letzte	Update anfordern
<input type="checkbox"/>	ARROW - VITEK MS RP5800 ACQ PC KIT CLI - 418884	Ihre Adressdaten	SYS-VITEK MS	Seriennummer	2023-12-28	
<input type="checkbox"/>	INCUB MOD RGHT W/RACKS 3D [U] - 210161U	Ihre Adressdaten	SYS-BacT/ALERT 3D 0480	Seriennummer	2024-01-16	
<input type="checkbox"/>	INCUBATOR MOD LEFT W/RACKS 3D - 210159	Ihre Adressdaten	SYS-BacT/ALERT 3D 0480	Seriennummer	2023-12-28	
<input type="checkbox"/>	INCUBATOR MOD RGHT W/RACKS 3D - 210161	Ihre Adressdaten	SYS-BacT/ALERT 3D 0960	Seriennummer	2023-12-28	
<input type="checkbox"/>	INCUBATOR MOD RGHT W/RACKS 3D - 210161	Ihre Adressdaten	SYS-BacT/ALERT 3D 0480	Seriennummer	2023-12-28	
<input type="checkbox"/>	MINI VIDAS - 410416	Ihre Adressdaten	SYS-MiniVIDAS	Seriennummer	2024-02-07	
<input type="checkbox"/>	VITEK 2 MODULE EU - 27202	Ihre Adressdaten	SYS-VITEK 2 0180	Seriennummer	2024-02-12	

Schritt 5: Bitte fordern Sie die jeweilige Änderung/ Update an Ihrem Gerät an.

The screenshot shows the Biomérieux user interface. At the top left is the Biomérieux logo. A search bar contains the text "Geben Sie ein Schlüsselwort oder eine Referenznummer ein." with a magnifying glass icon. To the right are icons for user profile, notifications, and a shopping cart with a red '5' badge. A dark blue navigation bar contains the following menu items: "PRODUKTE UND LÖSUNGEN", "ORDER MANAGEMENT", "RESOURCES", and "SUPPORT", each with a dropdown arrow.

Below the navigation bar, there are two main sections:

- OFFENE ÄNDERUNGEN MEINER INSTALLIERTEN BASIS**: A table with the following columns: "Art der Änderung", "System/Gerät", "Datum/Uhrzeit der Erö", and "Stand".
- BITTE FÜHREN SIE FOLGENDE ÄNDERUNG MEINER INSTALLIERTEN BASIS DURCH.**: A form with the following fields:
 - * Requester Name: Text input with "ContactDE Test".
 - * System: Text input with "SYS-VITEK MS".
 - Gerät: Dropdown menu showing "ARROW - VITEK MS RP5800 ACQ PC KIT CLI - 418884" and "Seriennummer".
 - * Art der Änderung: Dropdown menu with "keine -" selected. A yellow hand icon points to this dropdown. The dropdown list is open, showing the following options: "Gerätestatus", "Status", "Korrektur der Seriennummer", "Korrektur des Gerätestandortes", "Andere", and "Software update".

Hinweis: Bei der Änderung des Gerätestandorts können Sie diesen wie folgt anfordern:

The screenshot shows the Biomérieux user interface. At the top left is the Biomérieux logo. To its right is a search bar with the placeholder text "Geben Sie ein Schlüsselwort oder eine Referenznummer ein." and a magnifying glass icon. Further right are icons for user profile, notifications, and a shopping cart with a red notification badge. Below the search bar is a dark blue navigation bar with the following menu items: "PRODUKTE UND LÖSUNGEN", "ORDER MANAGEMENT", "RESOURCES", and "SUPPORT".

The main content area is divided into two columns. The left column is titled "OFFENE ÄNDERUNGEN MEINER INSTALLIERTEN BASIS" and contains a table with the following headers: "Art der Änderung", "System/Gerät", "Datum/Uhrzeit der Err", and "Stand".

The right column is titled "BITTE FÜHREN SIE FOLGENDE ÄNDERUNG MEINER INSTALLIERTEN BASIS DURCH." and contains a form with the following fields:

- * Requester Name: Text input field containing "ContactDE Test".
- * System: Text input field containing "SYS-VITEK MS".
- Gerät: Dropdown menu showing "ARROW - VITEK MS RP5800 ACQ PC KIT CLI - 418884" and "Seriennummer".
- * Art der Änderung: Dropdown menu showing "Korrektur des Gerätestandortes".
- * Angeforderte Änderung: Text input field containing "Gerät XY ist am 01.01.2025 zum Kunden 1000xxx umgezogen." A yellow hand icon points to this field.

At the bottom right of the form is a blue button labeled "Absenden".

Schritt 6: Bitte klicken Sie nun auf Absenden, um uns Ihre Änderungen zukommen zu lassen.

The screenshot shows the Biomérieux user interface. At the top left is the Biomérieux logo. To its right is a search bar with the placeholder text "Geben Sie ein Schlüsselwort oder eine Referenznummer ein." and a magnifying glass icon. Further right are icons for user profile, notifications, and a shopping cart with a red notification badge containing the number "5". Below these is a dark blue navigation bar with the following menu items: "PRODUKTE UND LÖSUNGEN", "ORDER MANAGEMENT", "RESOURCES", and "SUPPORT", each with a downward arrow.

The main content area is divided into two columns. The left column is titled "OFFENE ÄNDERUNGEN MEINER INSTALLIERTEN BASIS" and contains a table with the following headers: "Art der Änderung", "System/Gerät", "Datum/Uhrzeit der Eric", and "Stand". The right column is titled "BITTE FÜHREN SIE FOLGENDE ÄNDERUNG MEINER INSTALLIERTEN BASIS DURCH." and contains a form with the following fields:

- * Requester Name: ContactDE Test
- * System: SYS-VITEK MS
- Gerät: ARROW - VITEK MS RP5800 ACQ PC KIT CLI - 418884 Seriennummer
- * Art der Änderung: Korrektur des Gerätestandortes
- * Angeforderte Änderung: Gerät XY ist am 01.01.2025 zum Kunden 1000xxx umgezogen. |

At the bottom right of the form is a dark blue button labeled "Absenden". A yellow hand icon is pointing at this button, indicating the next step in the process.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.