


Anleitung zur Ausführung der Geräteinventur



Schritt 1: Klicken Sie im Kundenportal bitte auf Reiter „Support“



Stöbern Sie in unserem Katalog

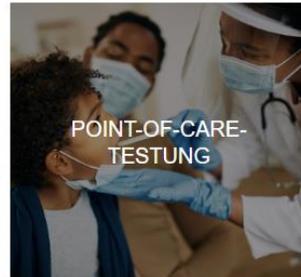

Ankündigungen


Template

2023-08-14
Produktdokumentation im Resource Center

2023-08-13
Verlinkung von QC-Zertifikaten für Ihre Reagenzien

[Mehr dazu](#)

Schritt 2: Bitte klicken Sie im Dropdown auf „Systems Overview“

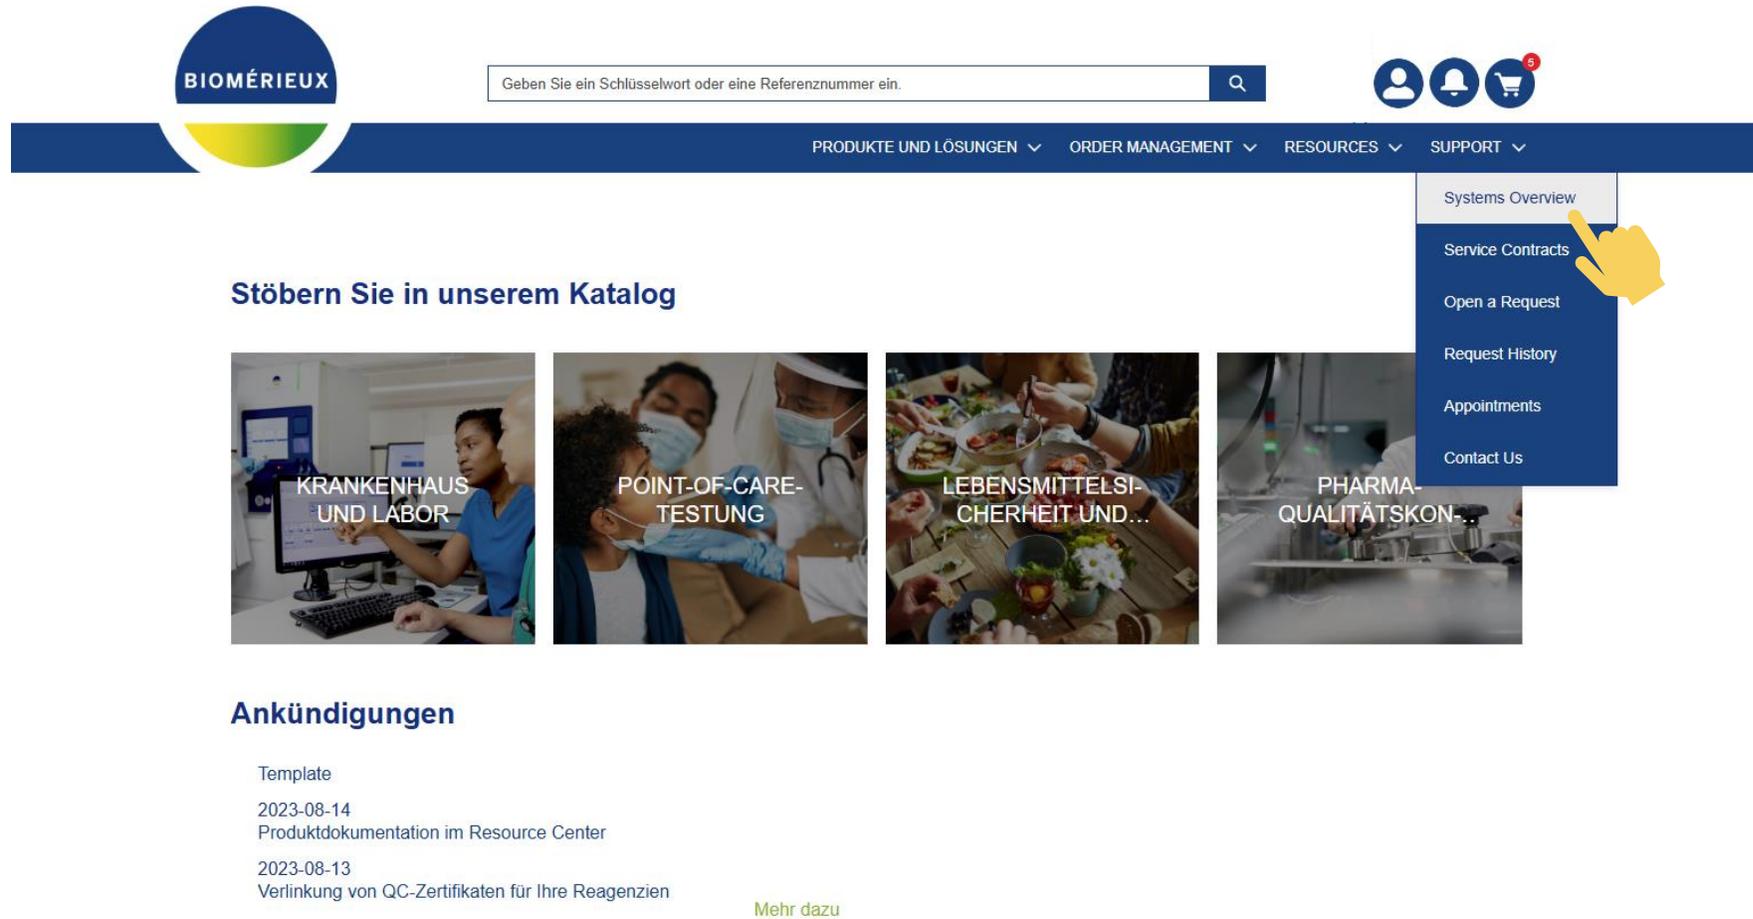

The screenshot shows the Biomérieux website interface. At the top left is the Biomérieux logo. A search bar contains the text "Geben Sie ein Schlüsselwort oder eine Referenznummer ein." with a magnifying glass icon. To the right are icons for user profile, notifications, and a shopping cart with a red notification badge showing the number "5". Below these is a dark blue navigation bar with the following menu items: "PRODUKTE UND LÖSUNGEN", "ORDER MANAGEMENT", "RESOURCES", and "SUPPORT". The "SUPPORT" menu is open, showing a dropdown list with the following options: "Systems Overview", "Service Contracts", "Open a Request", "Request History", "Appointments", and "Contact Us". A yellow hand icon is pointing to the "Systems Overview" option. Below the navigation bar, there is a section titled "Stöbern Sie in unserem Katalog" with four image-based categories: "KRANKENHAUS UND LABOR", "POINT-OF-CARE-TESTUNG", "LEBENSMITTELSICHERHEIT UND...", and "PHARMA-QUALITÄTSKON...". Below this is a section titled "Ankündigungen" with two announcements: one dated 2023-08-14 about product documentation in the Resource Center, and another dated 2023-08-13 about linking QC certificates for reagents. A "Mehr dazu" link is provided for the second announcement.

BIOMÉRIEUX

Geben Sie ein Schlüsselwort oder eine Referenznummer ein.

PRODUKTE UND LÖSUNGEN ▾ ORDER MANAGEMENT ▾ RESOURCES ▾ SUPPORT ▾

Systems Overview
Service Contracts
Open a Request
Request History
Appointments
Contact Us

Stöbern Sie in unserem Katalog

KRANKENHAUS UND LABOR

POINT-OF-CARE-TESTUNG

LEBENSMITTELSICHERHEIT UND...

PHARMA-QUALITÄTSKON...

Ankündigungen

Template

2023-08-14
Produktdokumentation im Resource Center

2023-08-13
Verlinkung von QC-Zertifikaten für Ihre Reagenzien

[Mehr dazu](#)

Schritt 3: Bitte klicken Sie nun in der nächsten Ansicht auf den Reiter „Ausstehende Aktion“



SYSTEMÜBERSICHT **AUSSTEHENDE AKTION**

System-Namen suchen Standort **alle Standorte**

Standortadresse	System-Name	System-Nummer	Anzahl der offenen Anfr...	System-Status	VILINK	Einzelheiten zum System
Ihre Adressdaten	SYS-APIWEB	Systemnummer	0	Aktiv	✕	🔍
Ihre Adressdaten	SYS-BacT/ALERT 3D 0480	Systemnummer	0	Aktiv	✕	🔍
Ihre Adressdaten	SYS-BacT/ALERT 3D 0960	Systemnummer	0	Aktiv	✕	🔍
Ihre Adressdaten	SYS-MiniVIDAS	Systemnummer	0	Aktiv	✕	🔍
Ihre Adressdaten	SYS-MYLA-MAESTRIA	Systemnummer	0	Aktiv	✕	🔍
Ihre Adressdaten	SYS-OBSERVA	Systemnummer	0	Inaktiv	✕	🔍

Schritt 4: Bitte klicken Sie nun das gewünschte System an und fordern Sie ein Update an, sofern eins erforderlich ist.

The screenshot shows the BIOMÉRIEUX web interface. At the top, there is a search bar with the text "Geben Sie ein Schlüsselwort oder eine Referenznummer ein." and a search icon. To the right of the search bar are icons for user profile, notifications, and a shopping cart with a red notification badge. Below the search bar is a navigation menu with the following items: "PRODUKTE UND LÖSUNGEN", "ORDER MANAGEMENT", "RESOURCES", and "SUPPORT".

The main content area is titled "SYSTEMÜBERSICHT" and "AUSSTEHENDE AKTION". Below this, there is a search bar for "Search equipment name" and a dropdown menu for "Standort wählen" set to "alle Standorte".

The main part of the interface is a table with the following columns: "Gerätename", "Standortadresse", "Verbunden mit", "Seriennummer", "Seriennummer, Datum der letzte", and "Update anfordern". A yellow hand cursor is pointing to the "Update anfordern" button for the first row.

<input type="checkbox"/>	Gerätename	Standortadresse	Verbunden mit	Seriennummer	Seriennummer, Datum der letzte	Update anfordern
<input checked="" type="checkbox"/>	ARROW - VITEK MS RP5800 ACQ PC KIT CLI - 418884	Ihre Adressdaten	SYS-VITEK MS	Seriennummer	2023-12-28	
<input type="checkbox"/>	INCUB MOD RGHT W/RACKS 3D [U] - 210161U	Ihre Adressdaten	SYS-BacT/ALERT 3D 0480	Seriennummer	2024-01-16	
<input type="checkbox"/>	INCUBATOR MOD LEFT W/RACKS 3D - 210159	Ihre Adressdaten	SYS-BacT/ALERT 3D 0480	Seriennummer	2023-12-28	
<input type="checkbox"/>	INCUBATOR MOD RGHT W/RACKS 3D - 210161	Ihre Adressdaten	SYS-BacT/ALERT 3D 0960	Seriennummer	2023-12-28	
<input type="checkbox"/>	INCUBATOR MOD RGHT W/RACKS 3D - 210161	Ihre Adressdaten	SYS-BacT/ALERT 3D 0480	Seriennummer	2023-12-28	
<input type="checkbox"/>	MINI VIDAS - 410416	Ihre Adressdaten	SYS-MiniVIDAS	Seriennummer	2024-02-07	
<input type="checkbox"/>	VITEK 2 MODULE EU - 27202	Ihre Adressdaten	SYS-VITEK 2 0180	Seriennummer	2024-02-12	

Schritt 5: Bitte fordern Sie die jeweilige Änderung/ Update an Ihrem Gerät an.

The screenshot shows the Biomérieux user interface. At the top left is the Biomérieux logo. A search bar contains the text "Geben Sie ein Schlüsselwort oder eine Referenznummer ein." with a magnifying glass icon. To the right are icons for user profile, notifications, and a shopping cart with a red notification badge. A dark blue navigation bar contains the following menu items: "PRODUKTE UND LÖSUNGEN", "ORDER MANAGEMENT", "RESOURCES", and "SUPPORT".

Below the navigation bar, there are two main sections:

- OFFENE ÄNDERUNGEN MEINER INSTALLIERTEN BASIS**: A table with the following columns: "Art der Änderung", "System/Gerät", "Datum/Uhrzeit der Erç", and "Stand".
- BITTE FÜHREN SIE FOLGENDE ÄNDERUNG MEINER INSTALLIERTEN BASIS DURCH.**: A form with the following fields:
 - * Requester Name: ContactDE Test
 - * System: SYS-VITEK MS
 - Gerät: ARROW - VITEK MS RP5800 ACQ PC KIT CLI - 418884 (Seriennummer)
 - * Art der Änderung: -keine - (dropdown menu with options: Gerätestatus, Status, Korrektur der Seriennummer, Korrektur des Gerätestandortes, Andere, Software update)

A yellow hand icon points to the "Gerätestatus" option in the dropdown menu.

Hinweis: Bei der Änderung des Gerätestandorts können Sie diesen wie folgt anfordern:

The screenshot shows the Biomérieux user interface. At the top left is the Biomérieux logo. To its right is a search bar with the placeholder text "Geben Sie ein Schlüsselwort oder eine Referenznummer ein." and a magnifying glass icon. Further right are icons for user profile, notifications, and a shopping cart with a red notification badge. Below the search bar is a dark blue navigation bar with the following menu items: "PRODUKTE UND LÖSUNGEN", "ORDER MANAGEMENT", "RESOURCES", and "SUPPORT".

The main content area is divided into two columns. The left column is titled "OFFENE ÄNDERUNGEN MEINER INSTALLIERTEN BASIS" and contains a table with the following headers: "Art der Änderung", "System/Gerät", "Datum/Uhrzeit der Err", and "Stand".

The right column is titled "BITTE FÜHREN SIE FOLGENDE ÄNDERUNG MEINER INSTALLIERTEN BASIS DURCH." and contains a form with the following fields:

- * Requester Name: Text input field containing "ContactDE Test".
- * System: Text input field containing "SYS-VITEK MS".
- Gerät: Dropdown menu showing "ARROW - VITEK MS RP5800 ACQ PC KIT CLI - 418884" and "Seriennummer".
- * Art der Änderung: Dropdown menu showing "Korrektur des Gerätestandortes".
- * Angeforderte Änderung: Text input field containing "Gerät XY ist am 01.01.2025 zum Kunden 1000xxx umgezogen." A yellow hand icon points to this field.

At the bottom right of the form is a blue button labeled "Absenden".

Schritt 6: Bitte klicken Sie nun auf Absenden, um uns Ihre Änderungen zukommen zu lassen.

The screenshot shows the Biomérieux web application interface. At the top left is the Biomérieux logo. A search bar contains the text "Geben Sie ein Schlüsselwort oder eine Referenznummer ein." with a magnifying glass icon. To the right are icons for user profile, notifications, and a shopping cart with a red '5' badge. A dark blue navigation bar contains the following menu items: "PRODUKTE UND LÖSUNGEN", "ORDER MANAGEMENT", "RESOURCES", and "SUPPORT", each with a dropdown arrow.

Below the navigation bar, there are two main sections:

- OFFENE ÄNDERUNGEN MEINER INSTALLIERTEN BASIS**: This section contains a table with the following headers: "Art der Änderung", "System/Gerät", "Datum/Uhrzeit der Eric", and "Stand".
- BITTE FÜHREN SIE FOLGENDE ÄNDERUNG MEINER INSTALLIERTEN BASIS DURCH.**: This section contains a form with the following fields:
 - * Requester Name**: Text input field containing "ContactDE Test".
 - * System**: Text input field containing "SYS-VITEK MS".
 - Gerät**: Dropdown menu showing "ARROW - VITEK MS RP5800 ACQ PC KIT CLI - 418884" and "Seriennummer".
 - * Art der Änderung**: Dropdown menu showing "Korrektur des Gerätestandortes".
 - * Angeforderte Änderung**: Text area containing "Gerät XY ist am 01.01.2025 zum Kunden 1000xxx umgezogen. |".

At the bottom right of the form, there is a dark blue button labeled "Absenden". A yellow hand icon is pointing at this button.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.